



Visual IR Thermometer VT02, VT04

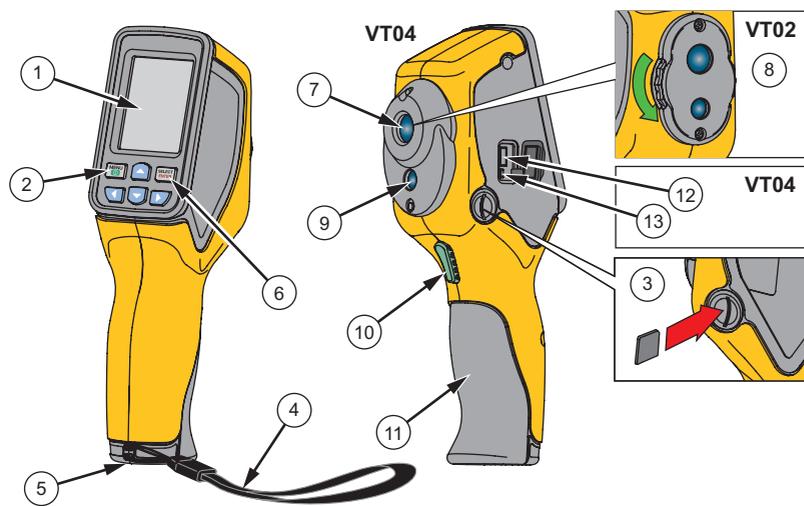


- ① ЖК-дисплей
- ② Вкл./Выкл. и меню
- ③ Разъем для карт памяти SD
- ④ Ремешок
- ⑤ Крепление штатива
- ⑥ Выбор/ввод
- ⑦ Объектив инфракрасного диапазона
- ⑧ Поворотная крышка объектива
- ⑨ Видеокамера
- ⑩ Пусковой рычажок записи изображения
- ⑪ Крышка элемента питания
- ⑫ Разъем Micro USB (VT04)
- ⑬ Светодиод состояния заряда аккумулятора


Включение и выключение

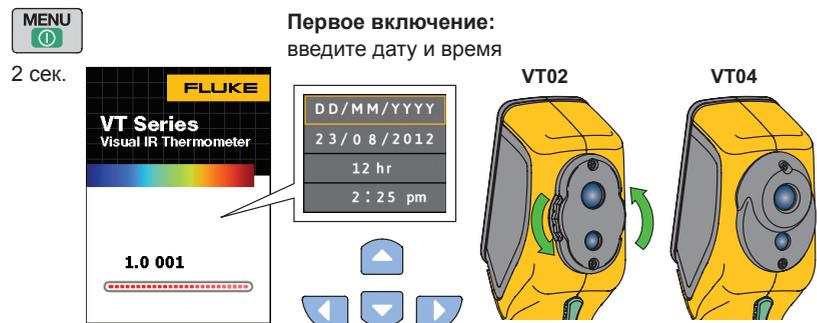

Наложение изображений

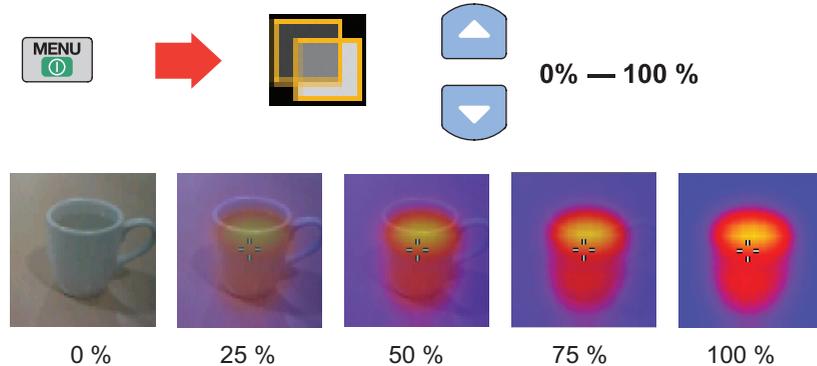

Съемка и сохранение

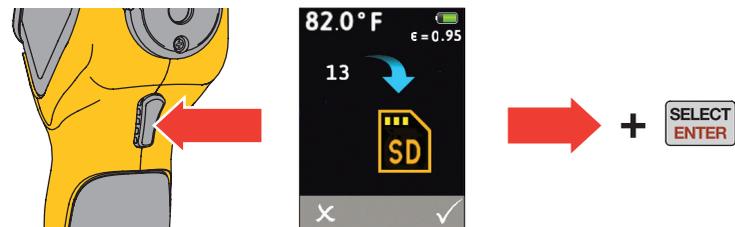

Меню функций и основы работы с меню



Пиктограмма	Описание	VT02	VT04
	0 Воспроизведение сохраненных изображений	•	•
	0.95 Коэффициент излучения	•	•
	Цветовая палитра	•	•
	20 °C Температура фона	•	•
	× Температурные маркеры	•	•
	°C Единицы измерения температуры	•	•
	5:12 Часы (Время и дата)	•	•
	× Сигнализация по верхнему и нижнему значению температуры		•
	× Регистрация изображений через определенный промежуток времени		•
	× Автоматический мониторинг		•


Контроль прямолинейности видимого изображения



Цветовая палитра




Дисплей измерений

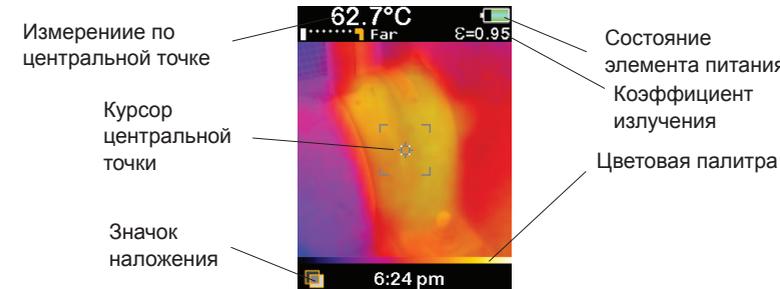


Карта SD




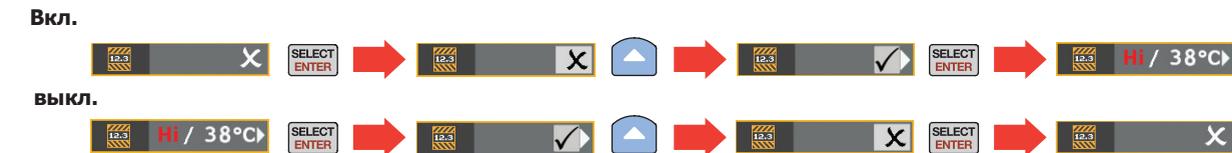



Сигнализация по верхнему и нижнему значению температуры

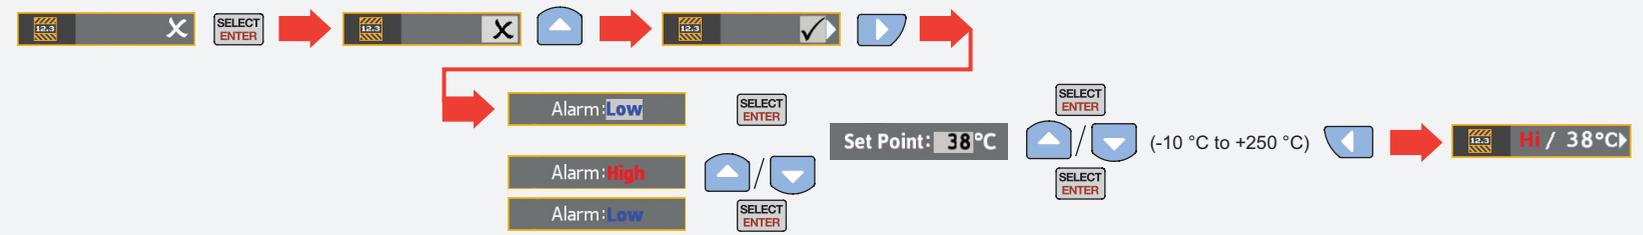


Автоматический мониторинг

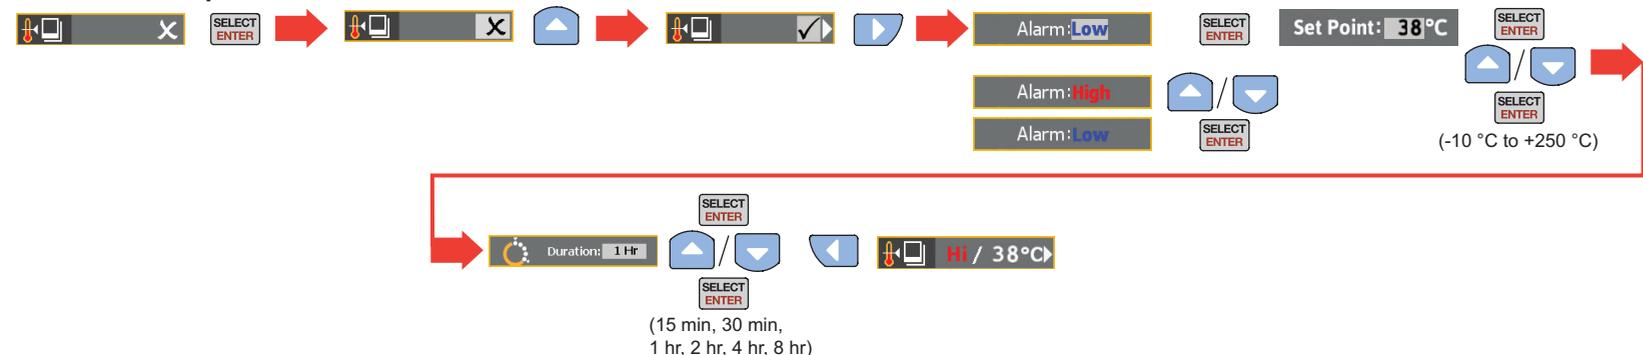

Регистрация изображений через определенный промежуток времени

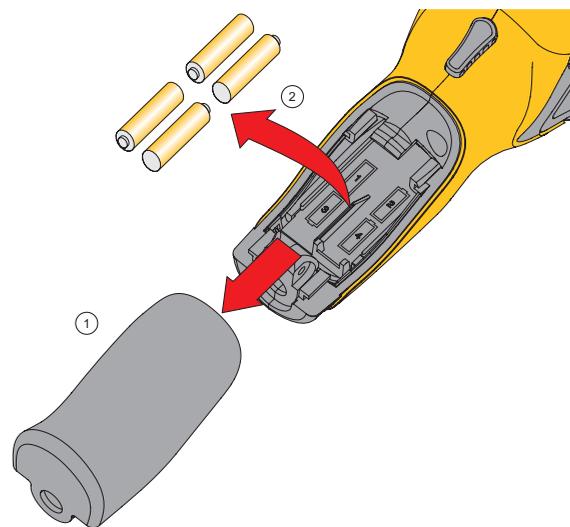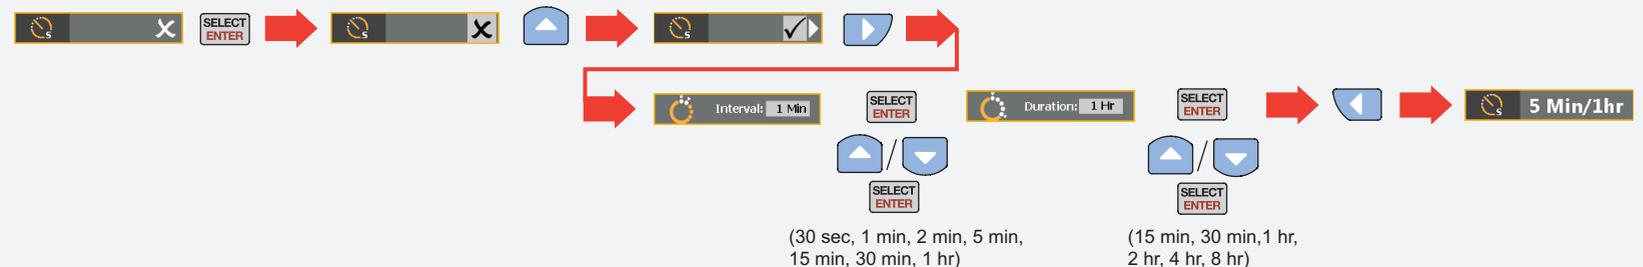

Аккумулятор (VT04)

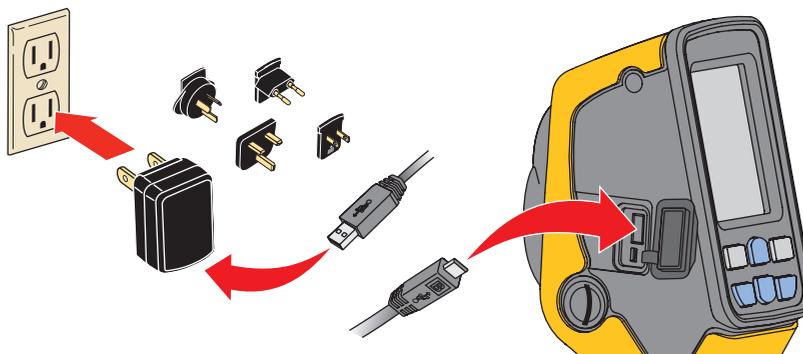

Предупреждение указывает на условия и процедуры, которые опасны для пользователя. **Предостережение** означает условия и действия, которые могут привести к повреждению Прибора или проверяемого оборудования.

⚠ Предупреждение

Следуйте данным инструкциям во избежание поражения электрическим током, возникновения пожара или травм:

- Перед использованием прибора ознакомьтесь со всеми правилами техники безопасности.
- Внимательно изучите все инструкции.
- Используйте прибор только по назначению. Ненадлежащая эксплуатация может привести к нарушению обеспечиваемой прибором защиты.
- Если загорелся индикатор низкого заряда батарей, их необходимо заменить. Это позволит избежать ошибок в измерениях.
- Не используйте прибор в среде взрывоопасного газа, испарений или во влажной среде.
- Не используйте прибор, если в его работе возникли неполадки.
- Не используйте прибор и отключите его, если он поврежден.
- Фактическая температура указана в информации об излучательной способности. Светоотражающие объекты показывают температуру ниже, чем фактическая температура. Использование таких объектов может привести к ожогу.
- Извлеките элементы питания, если устройство не используется длительное время, или если температура хранения превышает 50 °C. Если элементы питания остаются в устройстве, они могут потечь и повредить устройство.
- Используйте только одобренные сменные детали.
- Для зарядки аккумуляторов VT04 используйте только блоки питания, одобренные Fluke.

⚠ Предупреждение

Во избежание травм и для обеспечения безопасной работы и технического обслуживания Изделия выполняйте следующие требования.

- Элементы питания содержат взрывоопасные химические отравляющие вещества, которые могут привести к ожогам. При попадании химических веществ на кожу промойте ее водой и обратитесь за медицинской помощью.
- Чтобы избежать протекания, убедитесь, что полярность элементов питания соблюдена.
- Не замыкайте клеммы элемента питания.
- Храните элементы питания чистыми и сухими. Очищайте загрязненные клеммы сухой чистой тканью.
- Не разбирайте и не ломайте элементы питания.
- Не помещайте элементы питания вблизи от источника тепла или огня. Избегайте прямого попадания солнечных лучей.

Характеристики

Тип аккумуляторной батареи

VT04:	Литий-ионный аккумулятор, 3,6 В, 2250 мАч, 8,1 Вт·ч
VT02:	4 AA, LR6 1,5 В
Срок службы батареи:	8 ч
Рабочая температура	от -5 °C до +45 °C
Температура хранения:	от -20 °C до +60 °C
Высота над уровнем моря:	2 000 метров

В следующей таблице приведен список символов, используемых в устройстве и в этом руководстве.

Символ	Описание
⚠	Важная информация. См. руководство.
⚠	Опасное напряжение. Опасность поражения электрическим током.
♻ N10140	Соответствует действующим стандартам Австралии.
CE	Соответствие требованиям Европейского Союза и Европейской ассоциации свободной торговли.
KC	Соответствует стандартам электромагнитной совместимости (EMC) Южной Кореи.
♻ Li-ion	Эта камера содержит литий-ионную батарею. Не смешивать с общим потоком сточных вод. Отработанные батареи должны утилизироваться с помощью соответствующей перерабатывающей установки или устройства обработки опасных материалов в соответствии с местными нормами. По вопросам утилизации обратитесь к веб-сайту Fluke.
♻	Этот прибор соответствует требованиям к маркировке директивы WEEE (2002/96/EC). Данная метка указывает, что данный электрический/электронный прибор нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Категория устройства: согласно типам оборудования, перечисленным в Дополнении I директивы WEEE, данное устройство имеет категорию 9 "Контрольно-измерительная аппаратура". Не утилизируйте данное устройство вместе с несортированными отходами. По вопросам утилизации см. веб-сайт Fluke.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Fluke гарантирует отсутствие дефектов материала и изготовления на период 2 года с момента приобретения. Настоящая Гарантия не распространяется на предохранители, разовые батарейки, а также на случаи повреждения в результате несчастных случаев, небрежного обращения, внесения конструктивных изменений, повышенной загрязненности, ненадлежащего использования, обращения и ненадлежащих условий эксплуатации. Дилеры не имеют права предоставления каких-либо других гарантий от имени Fluke. Для получения гарантийного сервисного обслуживания в течение гарантийного периода обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Fluke за информацией о праве на возврат, затем отправьте продукт в этот сервисный центр с описанием проблемы.

ЭТО ВАША ЕДИНСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ. НАСТОЯЩИМ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, КАК, НАПРИМЕР, ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. FLUKE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ЯВИВШИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ КАКИХ-ЛИБО ДЕЙСТВИЙ ИЛИ МЕТОДОВ. Поскольку некоторые государства или страны не допускают исключения или ограничения косвенной гарантии или исключения и ограничения случайных или косвенных повреждений, ограничения этой гарантии могут не действовать в отношении вас.

Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA 98206-9090 U.S.A.	Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 5602 BD Eindhoven The Netherlands
--	--